



Feldname	Inhalt
Prüfer	Skorloff
Probenbezeichnung	241213P1_PF10_m1
Datum	2025.01.06
Meßlänge	4235,51µm
Meßgeschwindigkeit	0,300mm/s
Meßrichtung	Rechts
Tasterbenennung	DM43801
Typ	2 µm 60°

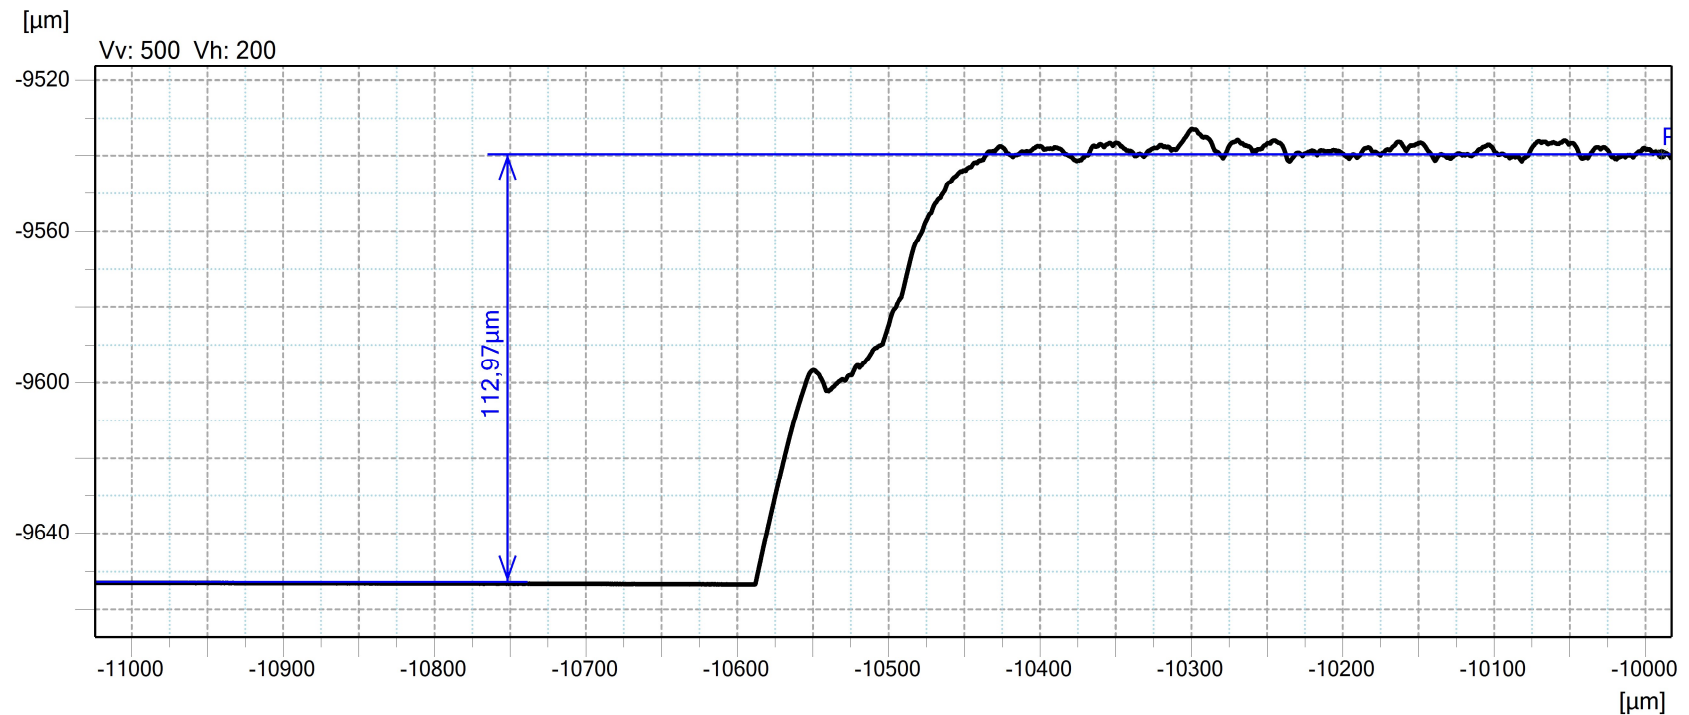

Feldname	Inhalt
Prüfer	Skorloff
Probenbezeichnung	241213P1_PF10_m2
Datum	2025.01.06
Meßlänge	4425,75µm
Meßgeschwindigkeit	0,300mm/s
Meßrichtung	Rechts
Tasterbenennung	DM43801
Typ	2 µm 60°

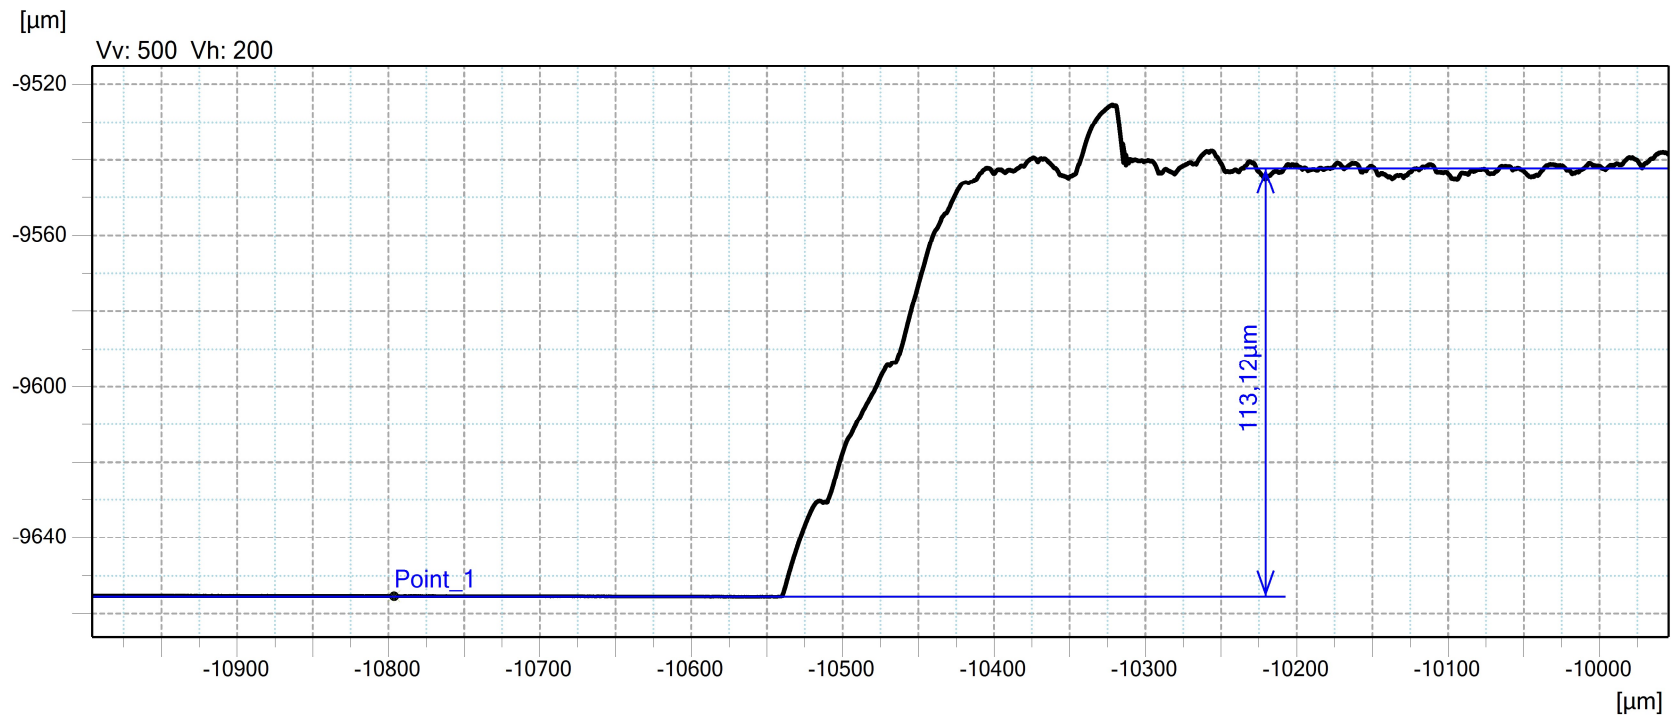

Feldname	Inhalt
Prüfer	Skorloff
Probenbezeichnung	241213P1_PF10_m3
Datum	2025.01.06
Meßlänge	4349,62µm
Meßgeschwindigkeit	0,300mm/s
Meßrichtung	Rechts
Tasterbenennung	DM43801
Typ	2 µm 60°

